


Pacjent: Jan Nowak, 23.02.1984 (37 lat(a))
Zarejestrowano: czwartek, 18 mar 2021, 9:36:40 AM
T 89 bpm
Czas trwania: 30s

Kardia Determination: Normal
* Kardia Determination is done on Lead I.

Kardia

Ulepszony filtr, Filtrowanie zasilania sieciowego: 50 Hz Skala: 25mm/s, 10mm/mV

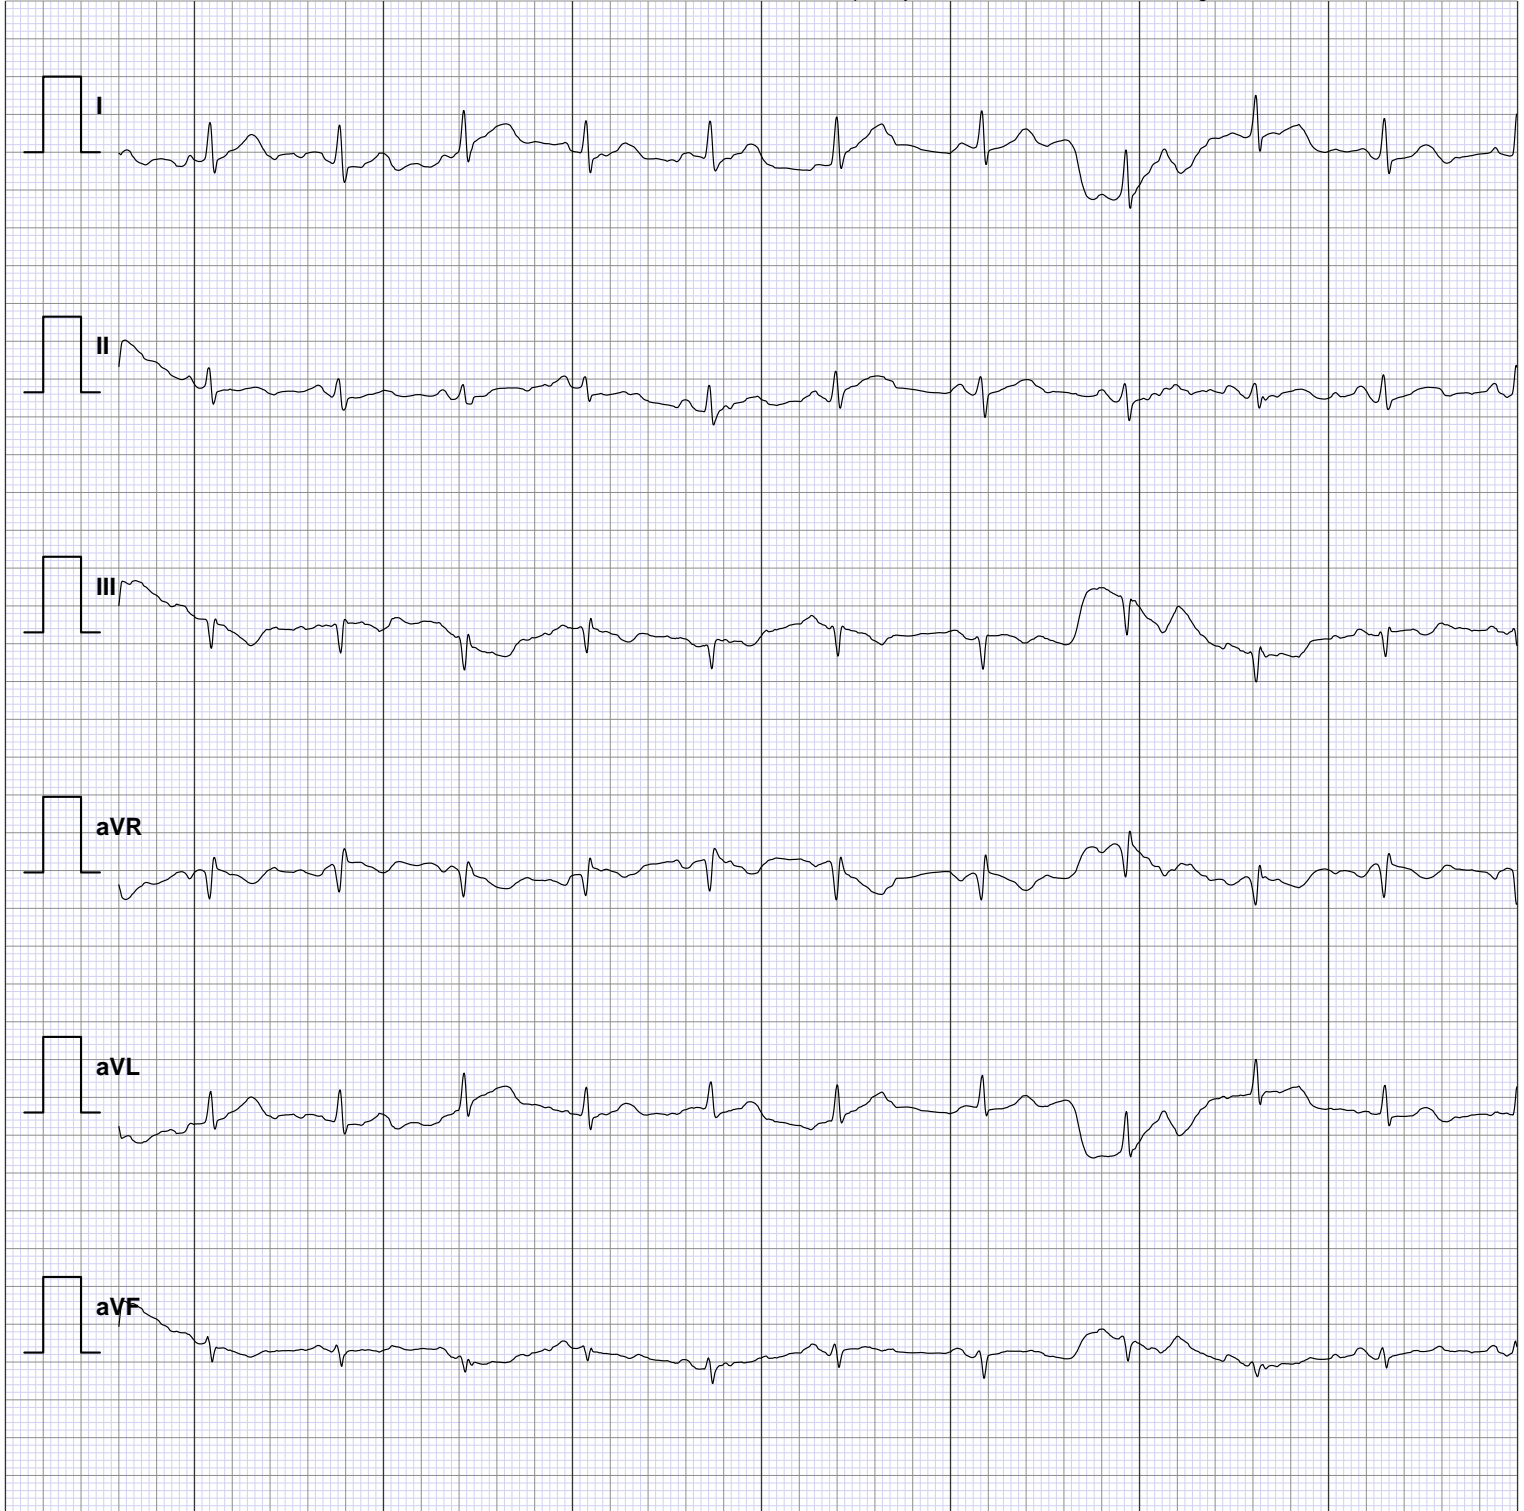


Pacjent: Jan Nowak, 23.02.1984 (37 lat(a))
Zarejestrowano: czwartek, 18 mar 2021, 9:36:40 AM
T 89 bpm
Czas trwania: 30s

Kardia Determination: Normal
* Kardia Determination is done on Lead I.

Kardia

Ulepszony filtr, Filtrowanie zasilania sieciowego: 50 Hz Skala: 25mm/s, 10mm/mV

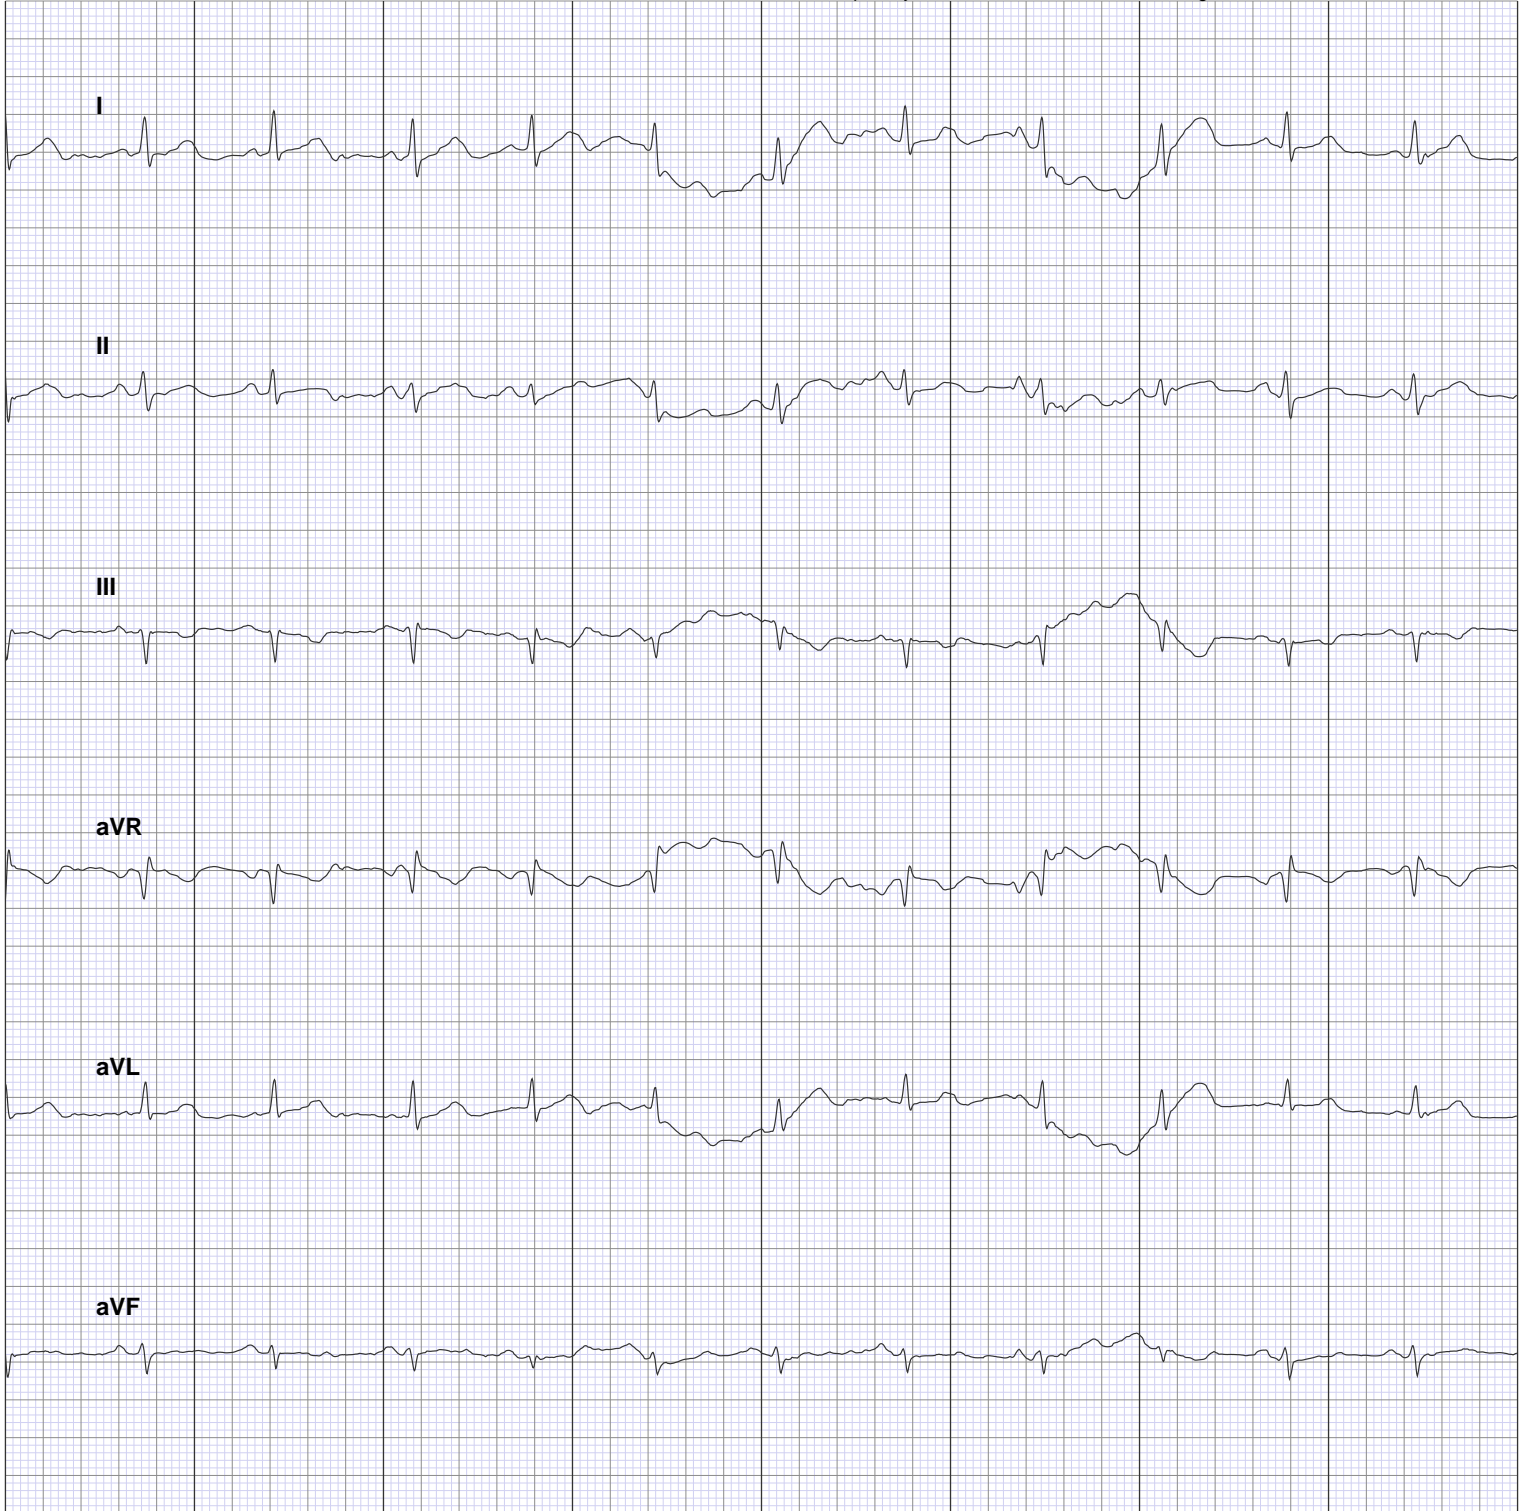


Pacjent: Jan Nowak, 23.02.1984 (37 lat(a))
Zarejestrowano: czwartek, 18 mar 2021, 9:36:40 AM
T 89 bpm
Czas trwania: 30s

Kardia Determination: Normal
* Kardia Determination is done on Lead I.

Kardia

Ulepszony filtr, Filtrowanie zasilania sieciowego: 50 Hz Skala: 25mm/s, 10mm/mV

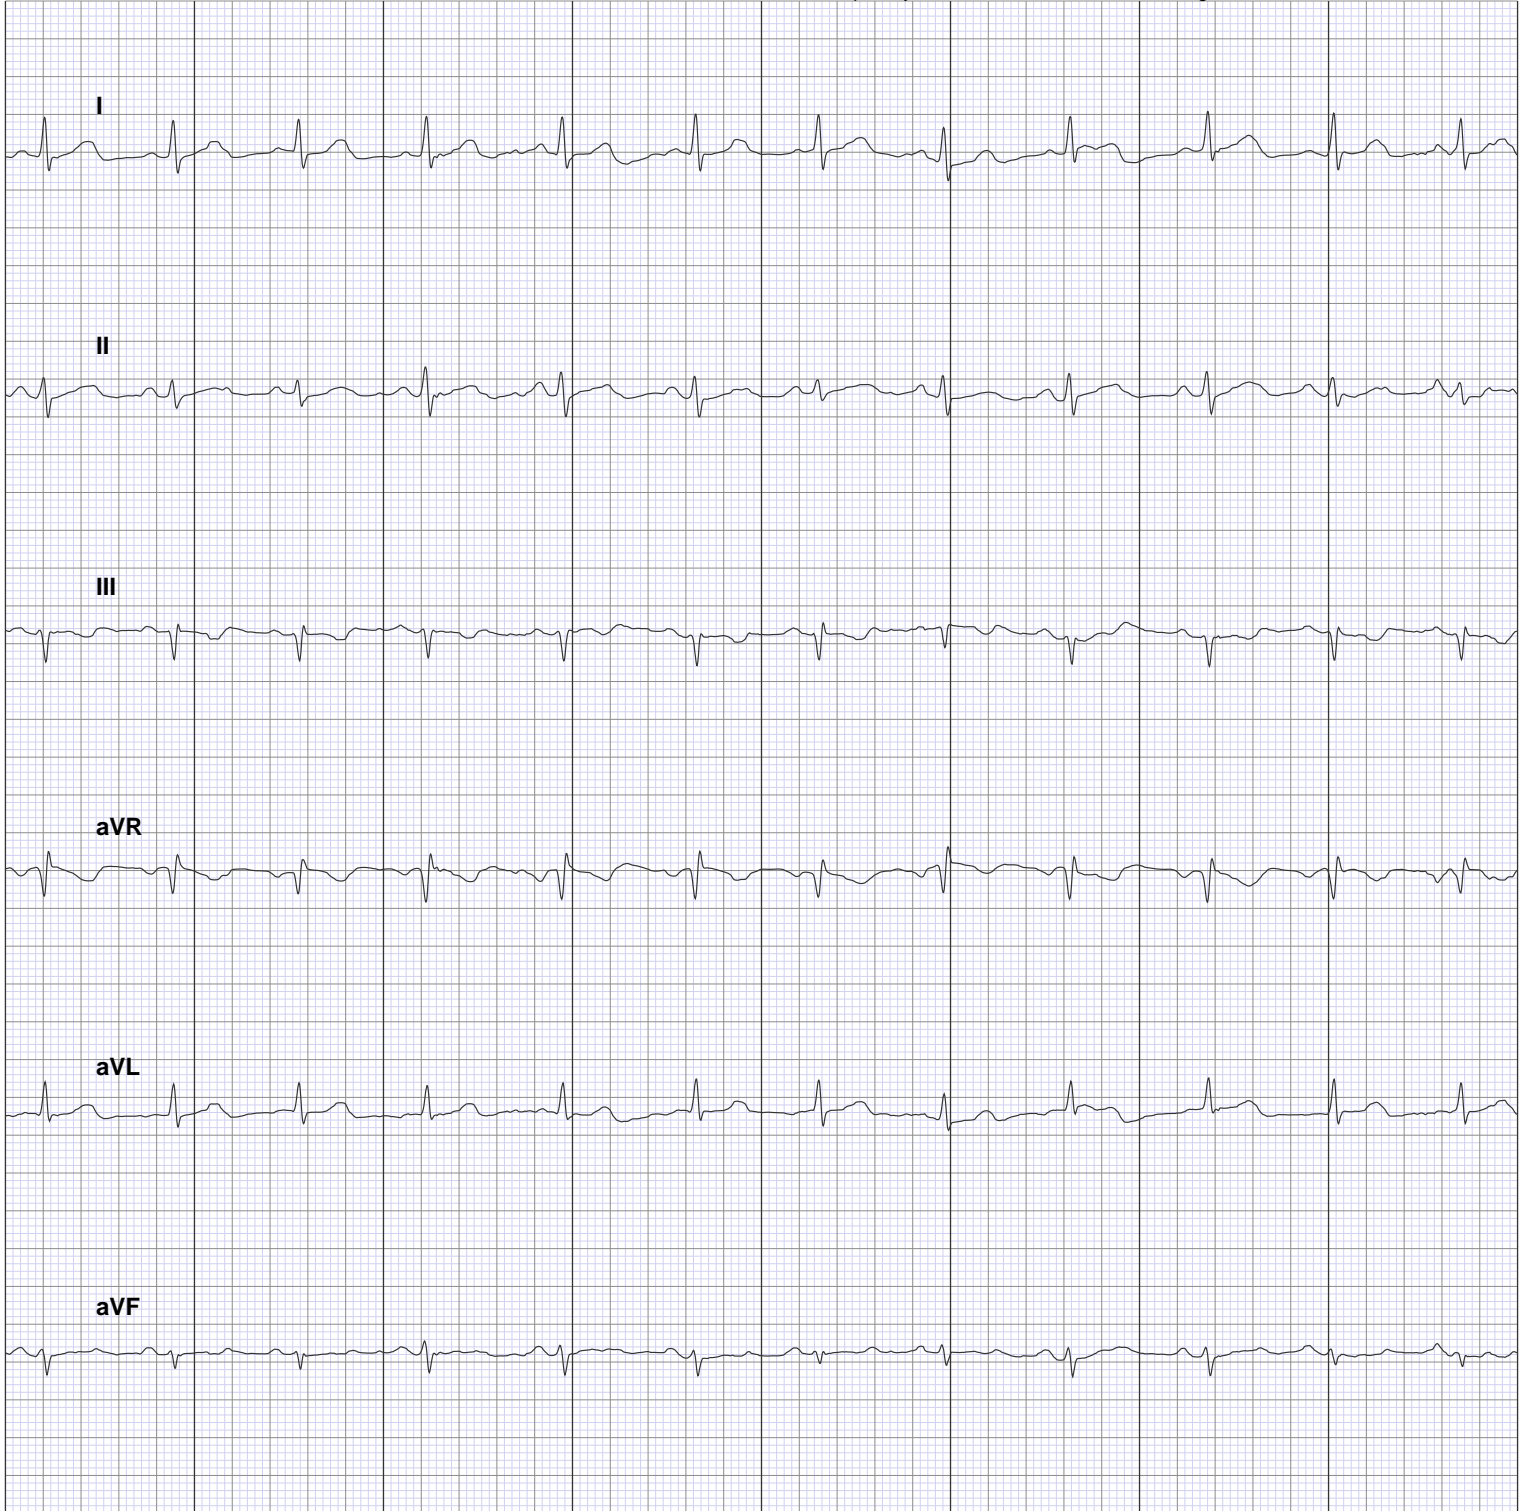

Pacjent: Jan Nowak, 23.02.1984 (37 lat(a))
Zarejestrowano: czwartek, 18 mar 2021, 9:36:40 AM
T 89 bpm
Czas trwania: 30s

Kardia Determination: Normal
* Kardia Determination is done on Lead I.

Kardia

Ulepszony filtr, Filtrowanie zasilania sieciowego: 50 Hz Skala: 25mm/s, 10mm/mV

